

高频电流探头

CP0XX0A/H 系列

CP0030A 35A/DC~ 55 MHz

CP0030H 30A/DC~110 MHz

CP0050A 50A/DC~ 55 MHz

CP0150A 160A/DC~12 MHz

CP0300A 350A/DC~ 6 MHz

CP0500A 500A/DC~ 5 MHz



前 言

首先,感谢您购买该产品。为了你安全正确地使用本产品,请先仔细阅读说明书。这份产品使用说明书是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。

说明书中,注释将用以下的符号进行区分。



该符号表示对人体和机器有危害,必须参照说明书操作。

警告

在错误操作的情况下,用户有受伤的威胁,为避免此类危险,记载了相关的注意事项。

注意

错误操作时,用户有受轻伤和物质损害的可能,为避免此类情况,记载的注意事项。

Note

记载着使用该机器时的重要说明。

为安全使用本机器

必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话,有可能会损害机器的保护功能。此外,因违反注意事项进行操作所产生的问题,本公司概不负责。



警告

- ◆ 为避免短路及人身事故,被测电路要求 300V 以下。
- ◆ 请避免接触裸导体。因为核心和屏蔽盖没有绝缘,有危险。
- ◆ 测量时请不要接触被测导体和传感器头。
- ◆ 连接本机器的输出端子 BNC 的示波器,也请使用带有保护接地的双重绝缘结构。
- ◆ 当示波器连接其它测试终端时,该测试终端会因为连接其他输入部分,使得本机器的连接端子和内部线路变成某种隐患,此时必须注意以下几点:
 - ◇ 连接本机器的测试终端和其他测试终端间,使用带有符合过电压范畴及污染度的基础绝缘设备
 - ◇ 若测试终端的基本绝缘无法满足的话,请不要输入超出安全的电压。
 - ◇ 请参照连接电器的触电等安全性相关的注意事项,进行使用。
- ◆ 机器潮湿,或用湿手测定的话,会发生触电事故,请注意。





注意

- ◆ 搬运和操作时，避免振动、冲击。特别是落下后产生的冲击。
- ◆ 避免阳光直射、高温、潮湿、结露的环境下保存和使用，会导致变形、绝缘恶化，不能满足使用规格。
- ◆ 使用前，请检查是否有由于苛刻的保存条件和运输等产生的产品故障，当确认故障时，请联系附近的代理店或运营商。
- ◆ 本机器没有防水、防尘构造，请不要在灰尘多和易浸水的环境中使用。
- ◆ 传感器头是由屏蔽壳、磁芯、霍尔原件构成的精密器件组装加工而成的零件。有时会因为急剧的周围温度变化，外力冲击等受到损伤，使用时请注意。
- ◆ 传感器头上下连接面，经过精密的研磨步骤生产。操作时请注意不要损伤连接面，有瑕疵的话会影响其功能。
- ◆ 传感器头上下连接面上粘到灰尘的话，也会影响其性能，请用柔软、防静电的布轻轻擦拭。
- ◆ 整体数据线和电源线，会因为断裂产生故障，因此，使用时请注意，不要折叠、拉拽。
- ◆ 去除机器污染时，在柔软的布上，放入少量中性洗涤剂，轻轻擦拭，绝对不能使用含石油精、酒精、丙酮、醚、酮、稀释剂，汽油等的洗涤剂，有可能导致变形、变色。
- ◆ 选择本产品标配的适配器供电。

CP0XX0A/H 系列产品简要说明

型号	连续电流最大值 (随频率的增加降低，参考各型号探头最大测量电流 VS 频率曲线图)	带宽	量程选择	电流传输比
CP0030A	35A	55MHz	35A/5A	1V/A (5A) 0.1V/A (35A)
CP0030H	30A	110MHz	30A/5A	1V/A (5A) 0.1V/A (30A)
CP0050A	50A	55MHz	50A/7.5A	1V/A (7.5A) 0.1V/A (50A)
CP0150A	160A	12MHz	160A/30A	0.1V/A (30A) 0.01V/A (160A)
CP0300A	350A	6MHz	350A/60A	0.1V/A (60A) 0.01V/A (350A)
CP0500A	500A	5MHz	500A/75A	0.1V/A (75A) 0.01V/A (500A)



目录

前言	1
CP0XX0A/H 系列简要说明	2
概述	4
应用	4
产品及附件说明	5
探头主体说明	5
附件说明	7
产品电气规格	8
机械规格	12
环境特性	12
操作方法	12
使用时的注意事项	12
测量前准备	13
消磁、调零	13
测量方法	13
一般异常时的处理方法	14
常见问题解答	14
装箱单	15



1. 概述

CPOXX0A/H 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括：高带宽，可准确快速捕捉电流波形；高精度，在电流测量量程范围内，精度高达 1%，满足大部分测试领域的需要；两个量程可供选择，方便小电流测量；自动消磁调零功能，使用方便；声光过流报警功能，提醒量程切换；电子轻触式按键设计，使用寿命更长；标准的 BNC 输出接口，可匹配任何厂家示波器。

CP0030A/H 体积轻巧，可在当前拥挤的电路板中使用自如；小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流，同时仍能夹住直径达 5mm 的导线；可以测量 35A 的连续电流和 50A 的峰值电流，CP0030A 提供 55MHz 的带宽，CP0030H 提供 110MHz 带宽；探头具有 35A/30A (10X) 和 5A (1X) 两个量程可选择，5A (1X) 量程特别适用于小电流测量，分辨率高达 1mA。

CP0050A 钳口可夹住直径达 5mm 的导线；可以测量 50A 的连续电流和 75A 的峰值电流，提供 55MHz 带宽；探头具有 50A (10X) 和 7.5A (1X) 两个量程可选择，7.5A (1X) 量程特别适用于小电流测量，分辨率高达 1mA。

CP0150A 钳口可夹住直径达 20mm 的导线，适用于大电流应用场合；可以测量 160A 的连续电流和 300A 的峰值电流，提供了 12MHz 的带宽；探头具有 160A (100X) 和 30A (10X) 两个量程可选择，10X 量程用于小电流测量，分辨率高达 10mA。

CP0300A 钳口可夹住直径达 20mm 的导线，适用于大电流应用场合；测量 350A 的连续电流和 500A 的峰值电流，提供了 6MHz 的带宽；探头具有 350A (100X) 和 60A (10X) 两个量程可选择，10X 量程用于小电流测量，分辨率高达 10mA。CPOXX0A/H 系列电流探头常用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED 照明、新能源等设计和测试应用中。

CP0500A 钳口可夹住直径达 20mm 的导线，适用于大电流应用场合；测量 500A 的连续电流和 750A 的峰值电流，提供了 5MHz 的带宽；探头具有 500A (100X) 和 75A (10X) 两个量程可选择，10X 量程用于小电流测量，分辨率高达 10mA。CPOXX0A/H 系列电流探头常用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED 照明、新能源等设计和测试应用中。

2. 应用


- 电源（开关式和线性）设计
- LED 照明设计
- 电动汽车设计
- 新能源
- 变频家电
- 电工实验
- 逆变器/变压器设计/半导体器件设计
- 电子镇流器设计
- 工控/消费电子设计
- 发动机驱动装置设计
- 电力电子和电力传动实验等
- 交通运输系统（电动车辆、机车、航空电子设备等）设计




3. 产品及附件说明

■ 探头主体说明

1) CP0030A CP0030H CP0050A

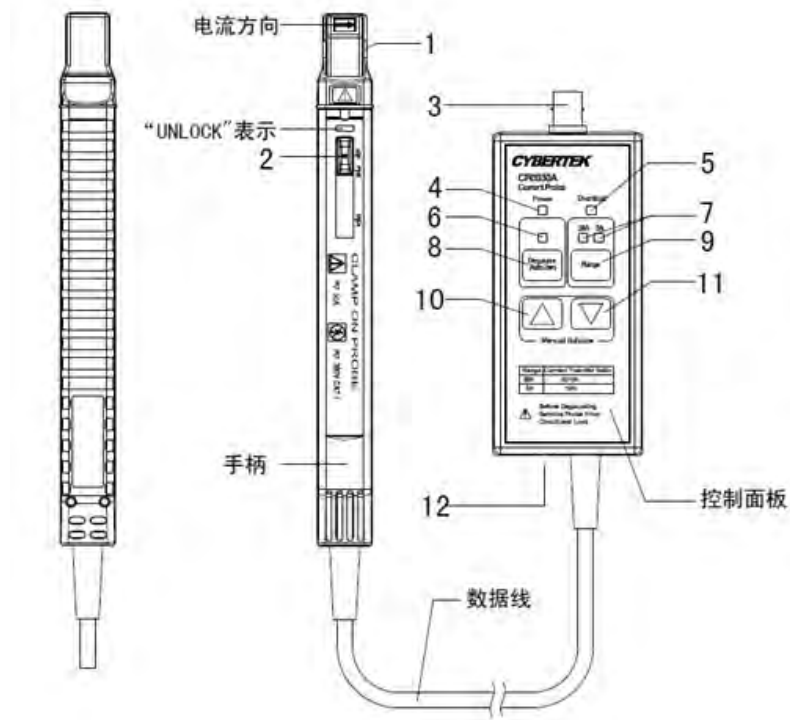

2) CP0150A、CP0300A、CP0500A

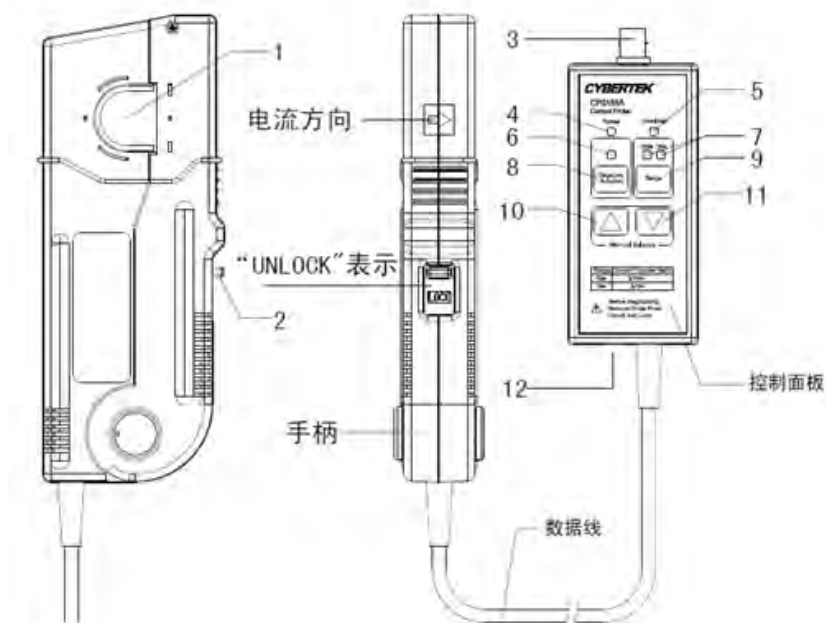

1. 传感器头

检测导体电流的核心元件。元件由一个精密的半导体等构成，周围温度的急剧变化，外部压力冲击等，有可能导致其受到损伤。因此操作时必须十分注意。

2. 开关控制杆

控制传感器头开合的操纵杆。测量电流时应先拉操纵杆打开传感器，放入被测导线。然后再推操纵杆使探头处于 LOCK 状态。

3. 输出接口

标准的 BNC 输出接口，通过标配的 BNC 同轴线可连接任何厂家的示波器。

4. 电源指示灯

通电后，指示灯亮绿色。

5. 过载指示灯

被测电流超过量程后，指示灯亮红色，并有报警声，提示切换量程。

6. 消磁指示灯

按下消磁按键后，该指示灯亮绿色，消磁结束后，指示灯灭。消磁若成功，蜂鸣器“滴滴”两声；消磁若失败，蜂鸣器“嘀”声延长，大约 1s。

7. 量程(Range)指示灯

指示当前量程状态。

8. 消磁自动调零(Degauss AutoZero)按钮

机器经常使用后，探头传感器会有剩余磁场。测量前先消磁调零，可提高测量精度。按下消磁自动调零按钮，机器消磁并自动调零，时间大约 5s。

9. 量程(Range)选择按钮

用于选择电流测量量程。

✧ CP0030A/H 分为 35A/30A 和 5A 两个量程：35A/30A 量程，探头电流传输比 0.1V/A；5A 量程，探头电流传输比 1V/A。

✧ CP0050A 分为 50A 和 7.5A 两个量程：50A 量程，探头电流传输比 0.1V/A；7.5A 量程，探头电流传输比 1V/A。

✧ CP0150A 分为 160A 和 30A 两个量程：160A 量程，探头电流传输比 0.01V/A；30A 量程，探头电流传输比 0.1V/A。

✧ CP0300A 分为 350A 和 50A 两个量程：350A 量程，探头电流传输比 0.01V/A；50A 量程，探头电流传输比 0.1V/A。

✧ CP0500A 分为 500A 和 75A 两个量程：500A 量程，探头电流传输比 0.01V/A；75A 量程，探头电流传输比 0.1V/A。

10. 手动偏置上调按钮

输出偏置上调按钮：每按一次，偏置向上步进一位；长按该按键 2s 左右，输出偏置将连续向上。一般用自动调零，无需使用此功能。




11. 手动偏置下调按钮

输出偏置下调按钮：每按一次，偏置向下步进一位；长按该按键 2s 左右，输出偏置将连续向下。一般用自动调零，无需使用此功能。


12. 电源插口

外部供电插孔，标配 DC12V/1.2A 适配器。

■ 附件说明



同轴电缆输出线 (CK-310)

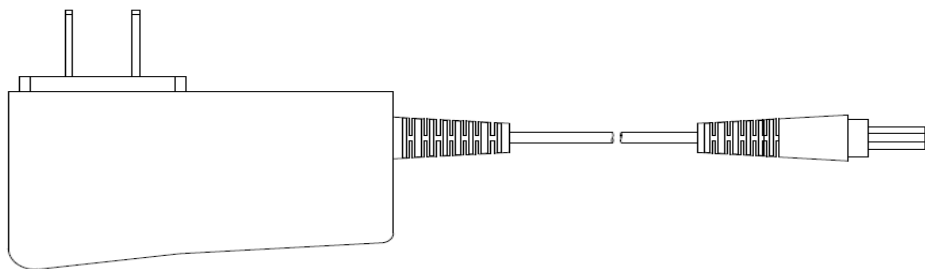

电源适配器 (CK-612)

产品标配附件说明：

同轴电缆输出线 (CK-310)	BNC 同轴线：100cm
电源适配器 (CK-612)	DC12V/1A



4. 产品电气规格

型 号		CP0030A/ CP0030H		CP0050A		CP0150A		CP0300A		CP0500A	
带宽(−3dB)		CP0030A	DC-55MHz (图 1. a)	DC-50MHz (图 4)		DC-12MHz (图 7)		DC-6MHz (图 10)		DC-5MHz (图 13)	
		CP0030H	DC-100MHz (图 1. b)								
上升时间		CP0030A	≤7ns	≤7ns		≤29ns		≤58ns		≤70ns	
		CP0030H	≤3. 5ns								
连续电流 最大值		CP0030A	35Arms 图 2. a	50Arms (图 5)		160Arms (图 8)		350Arms (图 11)		500Arms (图 14)	
		CP0030H	30Arms 图 2. b								
峰值电流		50Apk		75Apk		300Apk		500Apk		750Apk	
量程		5A	1X 衰减	7. 5A	1X 衰减	30A	10X 衰减	50A	10X 衰减	75A	10X 衰减
		35A/30A	10X 衰减	50A	10X 衰减	160A	100X 衰减	350A	100X 衰减	500A	100X 衰减
过流报警值		5A	≥5A	7. 5A	≥7. 5A	30A	≥30A	50A	≥50A	75A	≥75A
		35A/30A	≥50A	50A	≥75A	160A	≥300A	350A	≥500A	500A	≥750A
电流 传输比		5A	1V/A	7. 5A	1V/A	30A	0. 1V/A	50A	0. 1V/A	75A	0. 1V/A
		35A/30A	0. 1V/A	50A	0. 1V/A	160A	0. 01V/A	350A	0. 01V/A	500A	0. 01V/A
分辨率		5A	1mA	7. 5A	1mA	30A	5mA	50A	5mA	75A	5mA
		35A/30A	10mA	50A	10mA	160A	50mA	350A	50mA	500A	50mA
精度 (DC, 45-66Hz, 最大连续电流)		5A	±1%±1mA	7. 5A	±1%±1mA	30A	±1%±10mA	50A	±1%±10mA	75A	±1%±10mA
		35A/30A	±1%±10mA	50A	±1%±10mA	160A	±1%±100mA	350A	±1%±100mA	500A	±1%±100mA
输入阻抗		CP0030A	参考图 3. a	参考(图 6)		参考(图 9)		参考(图 12)		参考(图 15)	
		CP0030H	参考图 3. b								
延 时	探头主机	14ns		14ns		36ns		41ns		42ns	
	BNC(1m)	5ns									
终端负载要求		≥100k Ω									
供电方式		DC 12V/1A（标配适配器）									
绝缘线电压		300V CAT I					600V CATII 300V CATIII				
安全符合标准		EN61010-1: 2010									
EMC 符合标准		EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013									



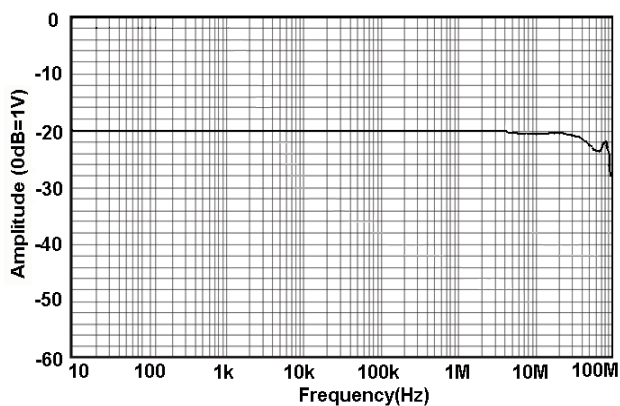


图 1.a CP00030A 幅频曲线

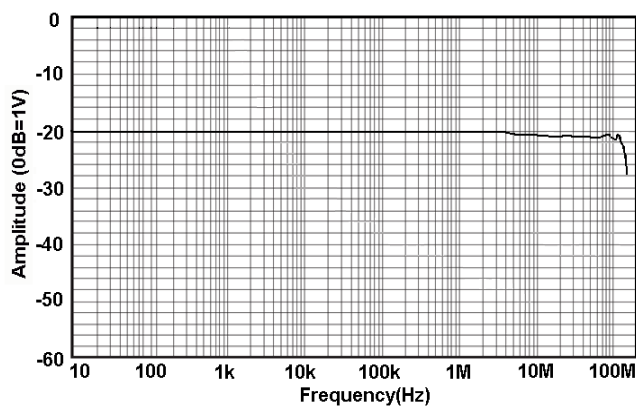


图 1.b CP00030H 幅频曲线

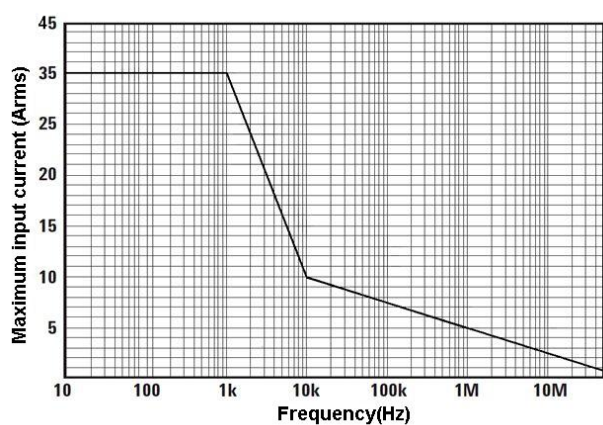


图 2.a CP00030A 最大测量电流 VS 频率曲线
(超过该曲线所示最大电流连续使用会导致探头烧毁)

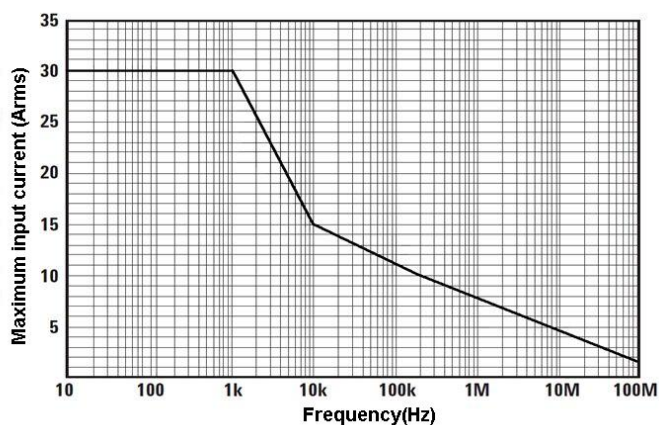


图 2.b CP00030H 最大测量电流 VS 频率曲线
(超过该曲线所示最大电流连续使用会导致探头烧毁)

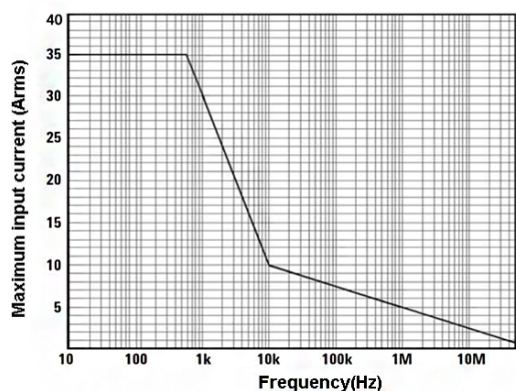


图 3.a CP00030A 输入阻抗 VS 频率曲线

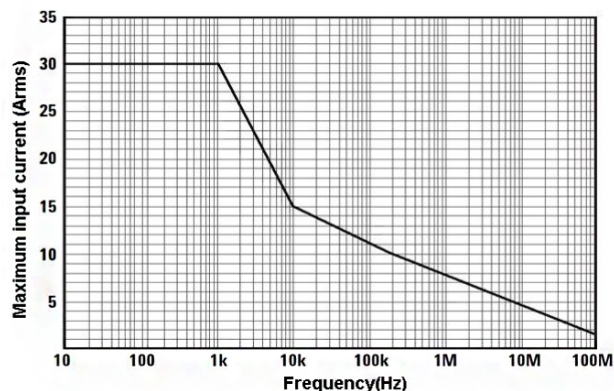


图 3.b CP00030H 输入阻抗 VS 频率曲线



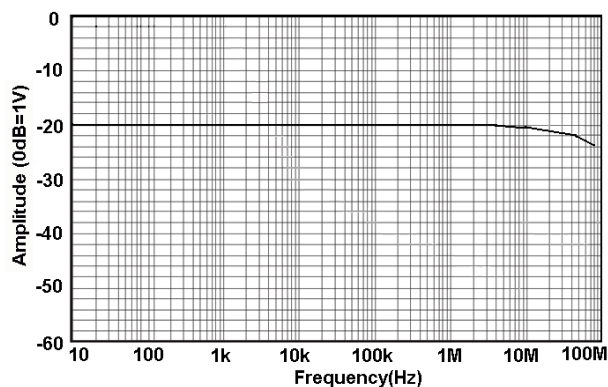


图 4 CP0050A 幅频曲线

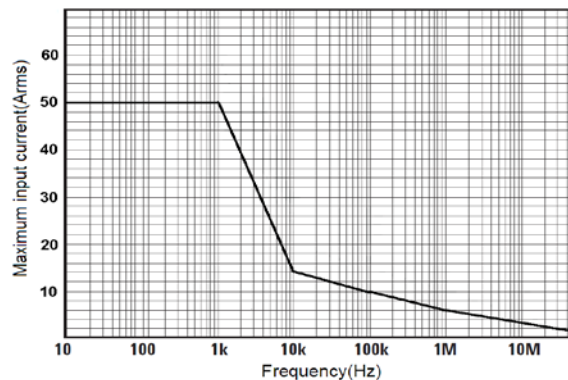


图 5 CP0050A 最大测量电流 VS 频率曲线
(超过该曲线所示最大电流连续使用会导致探头烧毁)

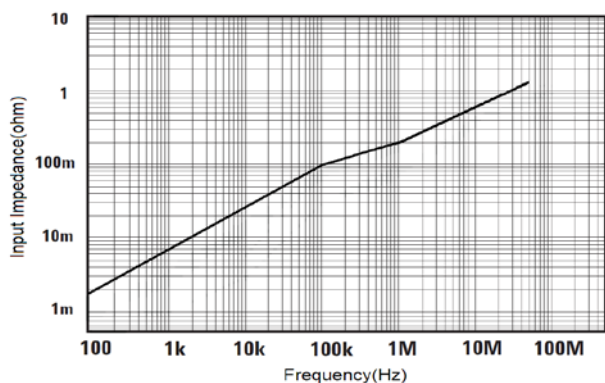


图 6 CP0050A 输入阻抗 VS 频率曲线

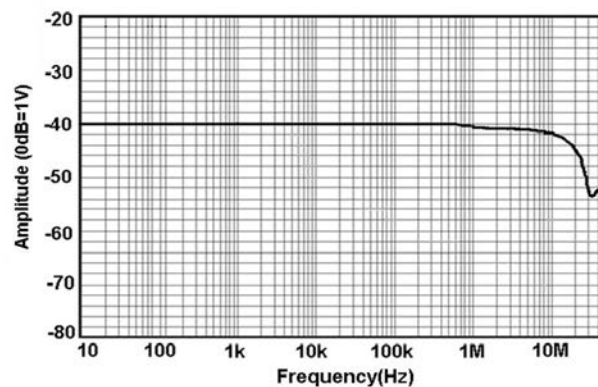


图 7 CP0150A 幅频曲线

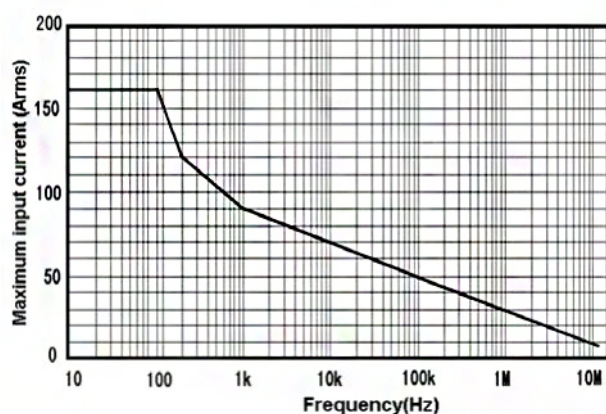


图 8 CP0150A 最大测量电流 VS 频率曲线
(超过该曲线所示最大电流连续使用会导致探头烧毁)

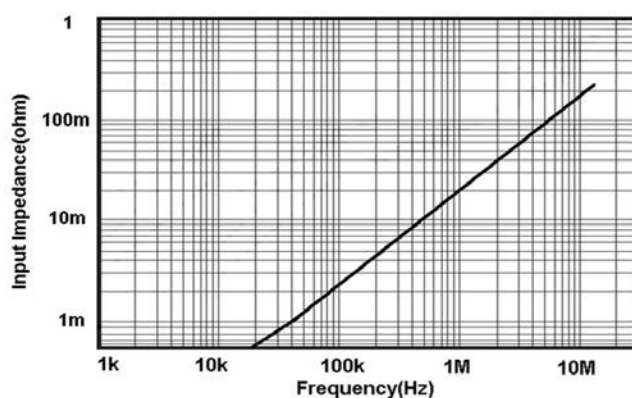


图 9 CP0150A 输入阻抗 VS 频率曲线



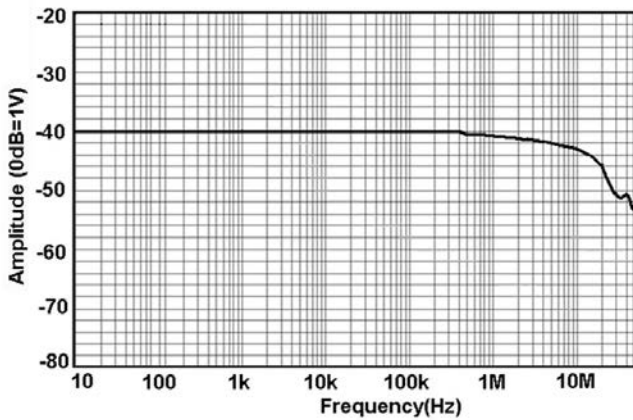


图 10 CP0300A 幅频曲线

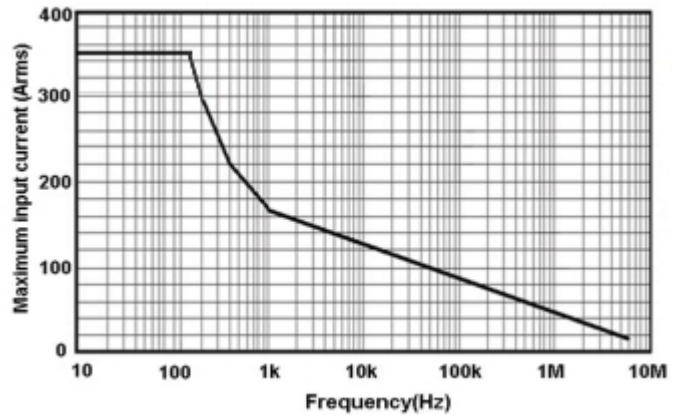


图 11 CP0300A 最大测量电流 VS 频率曲线
(超过该曲线所示最大电流连续使用会导致探头烧毁)

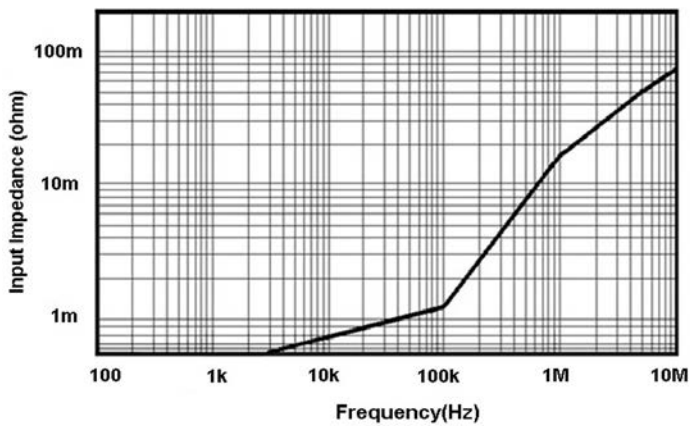


图 12 CP0300A 输入阻抗 VS 频率曲线

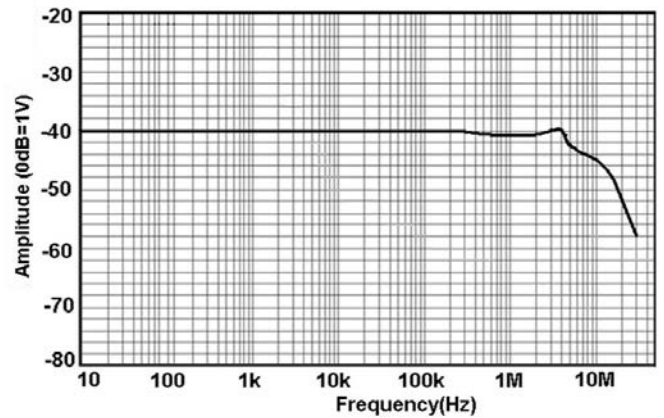


图 13 CP0500A 幅频曲线

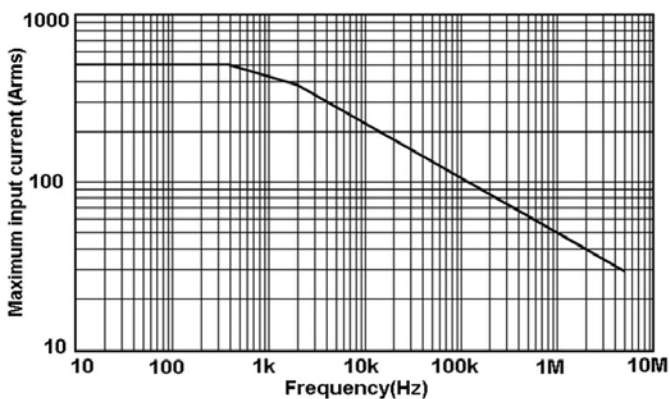


图 14 CP0500A 最大测量电流 VS 频率曲线
(超过该曲线所示最大电流连续使用会导致探头烧毁)

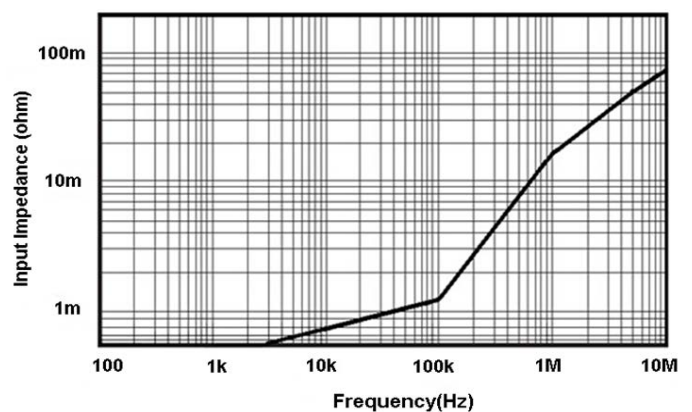


图 15 CP0500A 输入阻抗 VS 频率曲线



5. 机械规格

型 号	CP0030A/H	CP0050A	CP0150A	CP0300A	CP0500A
钳口直径	5mm		20mm		
数据线长度	1m		1. 5m		
同轴电缆输出线(CK-310)	100cm				
电源适配器(CK-612)	72*62*31mm 线长： 1. 5m				
电流钳手柄尺寸 (L*W*H)	175*40*18mm		175*68*29mm		
控制盒尺寸 (L*W*H)	119*49*28mm				
探头本体重量	255g		555g	525g	525g

6. 环境特性

工作温湿度	0-40℃, 80% or less
存储温湿度	-10-50℃, 80% or less
工作海拔高度	2000m
存储海拔高度	12000m

7. 操作方法

使用时的注意事项

Note


- ✧ 该机器的输出终端设置在内部，使用示波器时，请选择高输入电阻的（1MΩ）。若输入电阻为 50Ω，则不能正确测量。
- ✧ 确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值，磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉，过大的冲击电流，甚至会导致磁芯无法正确消磁，需重新调零。
- ✧ 插入电源后，本机器因自身发热等影响，有可能会有偏差，但大约 30 分钟后会基本稳定。
- ✧ 变压器、大电路等强磁场，无线电等强电流靠近时，有可能导致无法正常测定。
- ✧ 电压会因为周围温度等生偏差，所以在连续测定时必须注意。
- ✧ 有时被测电流的频率，会导致共振音的产生，这对测定没有影响。



- ✧ 会因被测导体在传感器头内的位置不同而产生影响，请把被测导体调至传感器头内中央位置。
- ✧ 测定时把开关控制杆推至“unlock”标志消失为止。确认控制杆锁定，整体部分确实关闭。如果整体部分没有确实关闭的话，将不能正常测定。
- ✧ 若在高频率领域，插入电路的高电位测的话，有可能会受到噪音影响，必要时可限定波形观测器的频段，或请插入低电位侧。

**注意**

- ✧ 拔出输出端子时，请在解锁后，拔出连接器，未解锁硬拽或硬拉电缆的话，输出终端会受损。
- ✧ 输入 BNC 端子以外的输入端子时，请注意输入端子的极性
- ✧ 持续最大输入范围是由机体自身发热后温度上升形成的固定值，请不要输入超出该固定值的电流，可能会损害机器。
- ✧ 持续最大输入范围会因测定电流的频率不同而不同。超过最大电流连续使用会导致探头烧毁。
- ✧ 当持续输入超出最大输入范围的电流时，会因传感器的发热，启动内部保护功能，变得不能正常输出。请立即停止输入电流，需要充分冷却后，才能进入下一次的正常运作。
- ✧ 如果在高温下，会因为内部过电流保护回路，通过持续最大输入范围以下的测定电流使得保护回路运作。
- ✧ 当连接输入超出最大输入范围电流时，让保护功能频繁运作，有可能会损害机器。
- ✧ 打开整体部分时，必须通过开关控制器进行操作。
- ✧ 在锁住 (LOCK) 状态下，请不要按下图方向，往整体部分上施加压力。

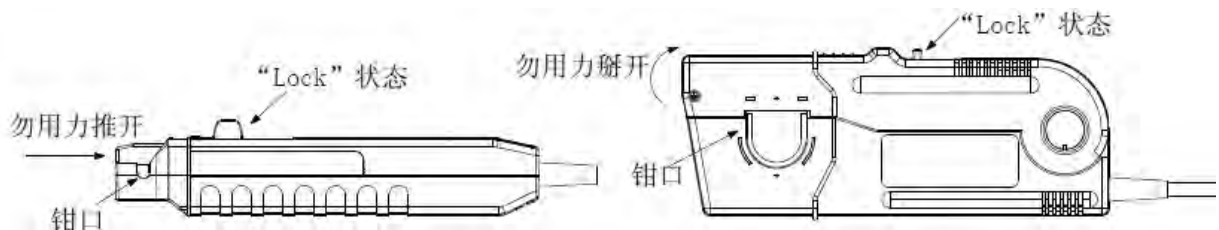

7.1 测量前准备:

- ✧ 准备好高频电流探头 CP0XX0A/H 系列产品、适配器（本公司配套适配器）、示波器。
- ✧ CP0XX0A/H 探头接上电源，绿色电源指示灯亮。
- ✧ 设置示波器：测量模式接地，示波器调零；示波器测量模式更改为 DC 模式。
- ✧ 根据被测电流大小，选择合适的量程，探头默认量程为大电流量程。

7.2 消磁、调零:

- ✎ 连接好 CP0XX0A/H 和示波器（确认示波器的输入阻抗设置为 $1M\Omega$ ）。
- ✎ 锁好探头，“UNLOCK”标志消失代表探头锁好。
- ✎ 按一下消磁自动调零按键进行消磁调零，大约 6s 后，会有成功提示音“滴滴”两声提示。

7.3 测量方法:

- ✧ 确认以上步骤无误。
- ✧ 拉开传感器的开关控制杆，打开传感器头，使得传感器前端标识的电流方向标记和被测电流流动方向一致，而且把被测导体夹在传感器头中部。
- ✧ 把传感器的开关控制杆推至“Unlock”标志消失为止，锁住探头，确认整体部分确实关闭了。观察测试波形，例如 CP0030A 的电流传输比选择的是 $0.1V/A$ （30A 量程），通过该公式，可以把波形观测器的电压灵敏度换算成电流灵敏度。例如，波形观测器的电压灵敏度是 $10mV/div$ 时，那么电流灵敏度是 $100mA/div$ 。



8. 一般异常情况的处理方法

问题	可能原因	处理方法
不能测定直流、或该频段测量值偏小	电源未打开	打开电源
	示波计测器设置成 AC 耦合	请设置成 DC 耦合方式
	传感器未锁定	请锁定传感器
自动消磁调零不成功	探头消磁调零时夹在正在工作的被测电路上	被测电路关闭后重新调零
在整个频段内振幅偏小	示波器等其他测试器的输入电阻为 50Ω	请调到 $1M\Omega$ 以上

9. 常见问题解答

9.1 CP0XX0A/H 系列产品是否匹配任何厂家示波器？

答：CP0XX0A/H 系列电流探头输出接口为标准的 BNC 接口，可匹配任何厂家示波器（示波器都是标准的 BNC 接口），供电是由标配的适配器供电，无需通过示波器供电，使用非常方便。

9.2 CP0XX0A/H 系列产品是否可以测量小电流？

答：可以。目前 CP0XX0A/H 系列电流探头有两个量程，测量小电流时选择低量程。CP0030A/CP0030H 的电流分辨率达到 $1mA$ 。测量小电流时，请精确消磁调零，调零后，探头手柄位置不要随意变动。为了更好的观看波形，把示波器带宽限制到 $20MHz$ ，排除不必要噪声的干扰。测量几 mA 小电流时可以把被测导线在探头中多绕几圈，得出结果除以相应圈数即为实际电流值。

9.3 使用探头时应该注意哪些？

答：

- ✧ 测量高频电流时，注意不要超过最大峰值电流 VS 频率曲线所示电流值，超过该曲线所示最大连续电流使用会导致探头烧毁；
- ✧ 为了能够准确测量，测量前请消磁调零，消磁调零时确保探头处于 LOCK 状态；
- ✧ 示波器输入阻抗设置为 $1M\Omega$ （默认值）；
- ✧ 测量时请确定探头处于 LOCK 状态；
- ✧ 测量时探头需远离干扰源，比如说变压器等。判断是否受到干扰的方法是：探头靠近被测电路，这时因为探头未夹电路，所以探头应该没有信号输出，如果有输出，环境可能存在干扰源。
- ✧ 被测电流不要超过探头的极限值。
- ✧ 注意保养探头，不要在过于潮湿的环境使用探头。
- ✧ 若探头出现问题，及时按保修卡说明返修，不可自行拆机，否则我司将不再保修。



10. 装箱单

装 箱 单	
名称	数量
电流探头本体	1 个
DC12V/1A 适配器	1 个
BNC 连接线 (CK-310)	1 条
高档工具包	1 个
说明书	1 本
保修卡	1 个
检测报告	1 份



典型合作客户



中国科学院



中国航天



中国航空工业集团公司



中国电子科技集团公司



上海汽车集团股份有限公司



上海汽车集团股份有限公司



北京汽车集团有限公司



东风汽车股份有限公司



广州汽车集团股份有限公司



北京汽车集团有限公司



美的集团股份有限公司



迈瑞医疗



Navitas Semiconductor Inc



中国中车股份有限公司



比亚迪股份有限公司




台达集团



广东欧珀移动通信有限公司



深圳麦格米特电气股份有限公司



德昌电机(深圳)有限公司



矽力杰半导体技术有限公司



北京鼎汉技术有限公司



易事特集团



深圳市盛弘电气股份有限公司



深圳市航嘉驰源电气股份有限公司



深圳市欣旺达电子有限公司



深圳市汇川技术股份有限公司



艾默生网络能源有限公司



阳光电源股份有限公司



PEKING UNIVERSITY



Tsinghua University



CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



SHENZHEN UNIVERSITY



FUDAN UNIVERSITY



Zhejiang University



CHANG'AN UNIVERSITY



SOUTHEAST UNIVERSITY



NANJING UNIVERSITY



SUN YAT-SEN UNIVERSITY



National University of Defense Tech



Tianjin University



WUHAN UNIVERSITY



TONGJI UNIVERSITY



CENTRAL SOUTH UNIVERSITY



XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



HUNAN UNIVERSITY



JILIN UNIVERSITY




SICHUAN UNIVERSITY



SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY



HONG KONG UNIVERSITY

